



50

Subsecretaría de Salud Pública  
División Prevención y Control de Enfermedades  
Departamento de Inmunizaciones  
MMR/FGE/GMV/MPBA/MA//FMR/CRP/CFB/mnh



2920

ORDINARIO B27 N° \_\_\_\_\_/

ANT.: Ord B27/N°1786 del 17 abril 2022  
Ord B27/N°2514 del 01 junio 2022

MAT.: Suspensión de indicación de uso de jeringas de graduación 0,02 mL para administración de dosis de refuerzo con vacuna del laboratorio Moderna.

SANTIAGO, 22 JUN 2022

DE : SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN

A través de la presente, se deja sin efecto el Ordinario B27/N°2514 del 01 de junio de 2022, debido a la regularización del abastecimiento a nivel nacional de la jeringa del laboratorio Cegamed con graduación de 0,01 mL para el uso de dosis de refuerzo de la vacuna contra SARS-CoV-2 del laboratorio Moderna.

De acuerdo a lo anterior, se debe continuar con la administración de la dosis aprobada para refuerzo de 0,25 mL en personas desde los 18 años en todo el territorio nacional.

Se solicita dar difusión a los distintos niveles de los establecimientos de salud públicos y privados.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted


DR. CRISTÓBAL CUADRADO NAHUM  
SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA

**Distribución:**

- Secretarios Regionales Ministeriales del país
- Directores de Servicio de Salud del país
- Encargados PNI de las Seremis del país
- Encargadas PNI de los Servicios de Salud del país
- Subsecretaría de Salud Pública
- Subsecretaría de Redes Asistenciales
- DIPRECE
- DIVAP
- Departamento de Inmunizaciones
- Oficina de Partes



Subsecretaría de Salud Pública  
División de Prevención y Control de Enfermedades  
Departamento de Inmunizaciones  
MMR/RGE/CCC/MAT/FMP/CDM

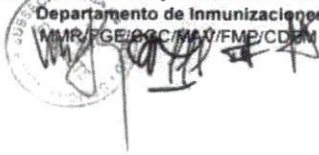

1786

ORDINARIO B27 N°

ANT.: No tiene.

MAT.: Indica uso jeringa 1 mL 25G x 1" para administración de vacuna Spikevax®.

SANTIAGO,

14 ABR 2022

DE : SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA

A : SECRETARIOS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD

El Departamento de Inmunizaciones ha gestionado la compra de jeringas de 1 mL con graduación de 0,01 mL con aguja de 25 G x 1", para la administración de la vacuna Spikevax® del laboratorio Moderna, como dosis refuerzo del esquema primario.

En base a lo anterior, informamos que la jeringa de 1 mL adjudicada es de marca Cegamed®, fue adquirida para el uso exclusivo en la administración de la vacuna Spikevax® en la dosificación de refuerzo (0.25 mL), por lo que los Depósitos de Vacunas e Inmunoglobulinas (DVI) deben asegurar la entrega de los insumos necesarios para la correcta inoculación de las personas. En anexo 1 se envía fotografías de esta jeringa.

La distribución de este insumo comenzará la semana del 11 de abril de 2022, iniciando en las regiones que ya cuentan con la vacuna de laboratorio Moderna. Posteriormente, el insumo será entregado a los DVI de todas las regiones del país.

Se les solicita realizar amplia difusión de este documento, con el fin de que esta información sea conocida por todos los niveles de ejecución del programa y equipos de salud del país.

Sin otro particular, saludan atentamente,

  
DR. CRISTÓBAL CUADRADO NAHUM  
SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA

**DISTRIBUCIÓN:**


- Secretarías/os Regional Ministerial de Salud
- Directoras/es Servicio de Salud
- Encargada PNI SEREMI de Salud del país.
- Encargada PNI Servicio de Salud del país
- Subsecretaría de Salud Pública
- Subsecretaría de Redes Asistenciales
- DIPRECE
- DIVAP
- Departamento de Inmunizaciones
- Oficina de Partes y Archivo

## Anexo 1

### Envase Primario



### Envase Secundario

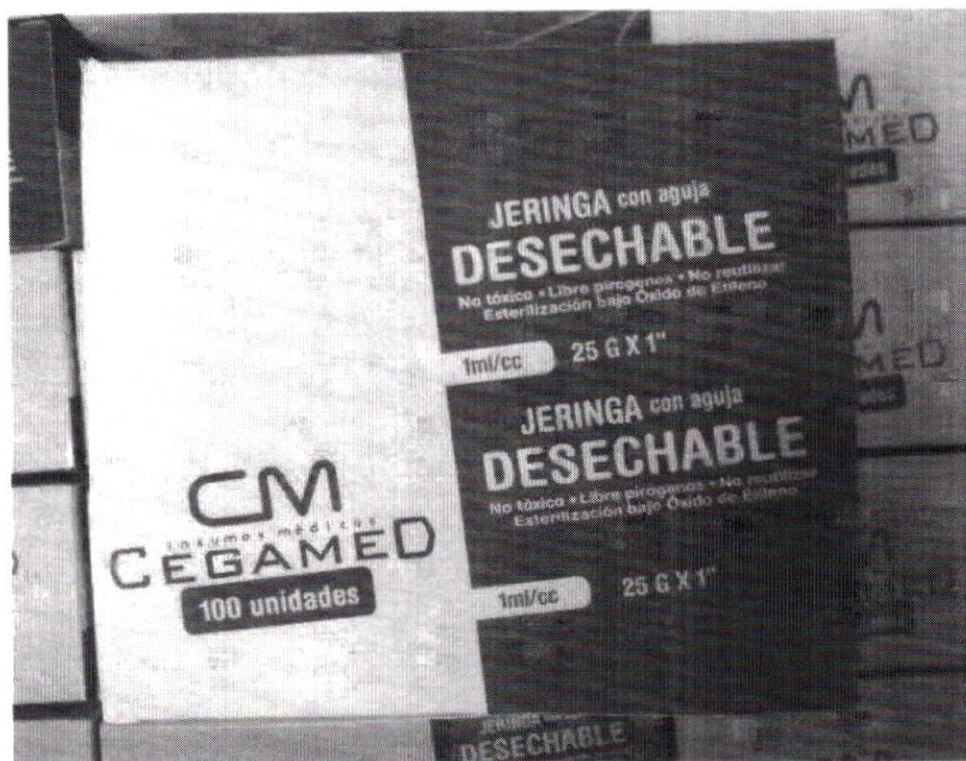



40  
Subsecretaría de Salud Pública  
División Prevención y Control de Enfermedades  
Departamento de Inmunizaciones  
MMR/PGE/CMV/MAY/MRI/LSS/CSG/FMP/CDP



2514

ORDINARIO B27 N° \_\_\_\_\_/

**ANT.:** Ord. B27/N°1786 del 17 abril 2022.

**MAT.:** Indicación uso jeringas para administración de dosis de refuerzo con vacuna del laboratorio Moderna.

SANTIAGO, 01 JUN 2022

**DE :** SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA

**A :** SEGÚN DISTRIBUCIÓN

El Departamento de Inmunizaciones, con el objetivo de mantener la continuidad en la vacunación contra SARS-CoV-2 en el país, indica que ante el posible riesgo de tener un stock limitado de jeringas del laboratorio Cegamed con graduación de 0,01mL que actualmente son de uso exclusivo para vacunación de refuerzo con vacuna del laboratorio Moderna, se debe:

1. Priorizar la utilización de las jeringas de Cegamed de 1 mL con graduación de 0,01mL, para uso exclusivo de refuerzo de vacuna del laboratorio Moderna.
2. Redistribuir estas jeringas en las comunas o regiones según requerimiento para la vacunación de refuerzo con vacuna del laboratorio Moderna a personas a partir de los 18 años.
3. De no disponer de este insumo, y habiendo agotado todas las posibilidades de redistribución, la indicación es utilizar jeringas de 1 mL de bajo espacio muerto de graduación 0,02 mL de los proveedores Zhejiang HuaFu Medical Equipment Co., Ltd o Shandong Bowei Medical Instruments Co., Ltd (R.A). (ver anexo N°1), para realizar vacunación en forma excepcional, como refuerzo en personas a partir de los 18 años con la vacuna del laboratorio Moderna con dosis de 0,26 mL, mientras no se disponga de las jeringas de 1 mL con graduación de 0,01mL.

Esta situación podría presentarse de forma transitoria durante las primeras dos semanas del mes de junio, y se calcula que según la disponibilidad proyectada no ocurrirá en todas las regiones del país, por lo que solicita realizar monitoreo exhaustivo del uso de esta jeringa (Cegamed).

Se solicita dar difusión a los distintos niveles de los establecimientos de salud públicos y privados.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted





*Cristobal Cuadrado Nahum*  
**DR. CRISTOBAL CUADRADO NAHUM**  
**SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA**

**Distribución:**

- Secretarios Regionales Ministeriales del país
- Directores de Servicio de Salud del país
- Encargados PNI de las Seremis del país
- Encargadas PNI de los Servicios de Salud del país
- Subsecretaría de Salud Pública
- Subsecretaría de Redes Asistenciales
- DIPRECE
- DIVAP
- Departamento de Inmunizaciones
- Oficina de Partes

Anexo N°1:

<p>Proveedor</p>	<p>Imagen jeringas de bajo espacio muerto - graduación 0,02 mL</p>
<p>Zhejiang HuaFu Medical Equipment Co., Ltd.</p>	 <p>The image shows the packaging for a Disposable Syringe with Needle. The text on the package includes: "Disposable Syringe with Needle 1ml 25G*25mm", "STERILE", "LATEX FREE", "CE 0197", and "ZHEJIANG HUAFU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.". There are also several warning symbols and instructions in Chinese and English.</p>
<p>Shandong Bowei Medical Instruments Co., Ltd (R.A.)</p>	 <p>The image shows the packaging for a Disposable Syringe 1ML. The text on the package includes: "Disposable Syringe 1ML", "Non-syngenic, latex-free", "Do not use if the package is open", "CE 0197", "STERILE", and "SHANGDONG BOWEI MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.". There are also several warning symbols and instructions in Chinese and English.</p>